

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE MORCELADOR HISTEROSCOPICO PARA POLIPECTOMIAS Y MIOMECTOMIAS PARA LA UDAD DE HISTEROSCOPIA DEL SERVICIO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE.

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y el artículo 68 del RGLCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del **SUMINISTRO DE MORCELADOR HISTEROSCOPICO PARA POLIPECTOMIAS Y MIOMECTOMIAS PARA LA UDAD DE HISTEROSCOPIA DEL SERVICIO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE.**

LOTE	CÓDIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCIÓN TÉCNICA)
1	018953	MORCELADOR PARA POLIPECTOMÍA: - Vaina y cuchilla de acero inoxidable desechables. - Mango con sistema aspiración desechable. Longitud de la ventana: 10,2 mm Diámetro exterior del dispositivo: 3 mm Profundidad de la ventana: 1,5 mm Volumen de aspiración: 31 mm ³ Longitud de trabajo: 32 cm Válido para histeroscopia: 6,2 mm
2	018956	MORCELADOR PARA MIOMECTOMÍA: - Vaina y cuchilla de acero inoxidable desechables. - Mango con sistema aspiración desechable. Longitud de la ventana: 14 mm Diámetro exterior del dispositivo: 3 mm Profundidad de la ventana: 1,8 mm Volumen de aspiración: 54 mm ³ Longitud de trabajo: 32 cm Válido para histeroscopia: 6,2 mm
3	018957	KIT SELLADO HISTEROSCOPIO: Válvula de Silicona no rígida, estéril para el sellado del canal de trabajo del histeroscopia.

El adjudicatario entregará en cesión de uso durante la vigencia del contrato para la realización de la técnica solicitada un histeroscopia y una unidad de control con las características que se describen a continuación y adicionalmente, si fuese necesario, también cederá una bomba de aspiración.

- **HISTEROSCOPIO:**
 - Histeroscopia monobloque con canal de lavado y trabajo extraíble con lentes cilíndricas.
 - Flujo continuo a través de un canal de salida extraíble.
 - Sistema de válvula que evita la fuga de líquido y presión.
 - Canal de trabajo para instrumentos de hasta 9 Fr. (6,2 mm)
- **UNIDAD DE CONTROL (GENERADOR):**
 - Velocidad de corte: 8075 RPM y 3 ciclos rotación/seg


MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS:

SI, UNA UNIDAD POR CADA LOTE

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Madrid, 03 de septiembre de 2018

SUBDIRECTOR MÉDICO
MATERNO INFANTIL

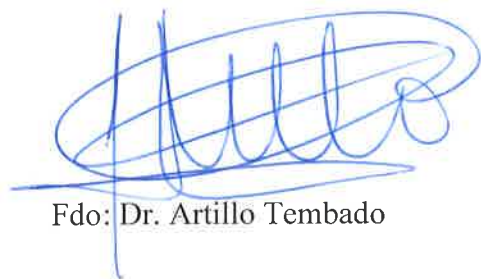

Fdo: Dr. Artillo Tembado

JEFE DE SERVICIO GINECOLOGÍA
Y OBSTETRICIA



Fdo: Dr. Alberto Galindo Izquierdo

JEFE DE SECCIÓN DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA



Fdo.: Dr. José L. Muñoz González

EXPEDIENTE 2018-0-34
SUMINISTRO DE MORCELADOR HISTEROSCOPICO PARA POLIPECTOMIAS Y MIOMECTOMIAS PARA LA UDAD DE HISTEROSCOPIA DEL SERV^a
DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA

LOTE	COD. ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 12 MESES	ANEXO		
				BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL
1	018953	MORCELADOR HISTEROSCOPIO PARA POLIPECTOMIAS	129	65.570,70	13.769,85	79.340,55
2	018956	MORCELADOR HISTEROSCOPIO PARA POLIPECTOMIAS	66	37.950,00	7.969,50	45.919,50
3	018957	KIT SELLADO HISTEROSCOPIO	200	4.600,00	966,00	5.566,00
				108.120,70	22.705,35	130.826,05