

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE UN LASER COMBO Nd-YAG/SLT, PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA, EN LA SECCIÓN DE GLAUCOMA, DEL HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS.

PAS 2018-7-197

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Láser con dos utilidades: YAG y SLT

Fuente láser: Q-switched Nd-YAG.

Energía Rango Mínimo. 0,3-10 mJ (YAG), 0,3 – 2 mJ (SLT)


Diámetro: 8 micras (YAG), 400 micras (SLT)

Longitud de onda: 532 nm (SLT), 1064 (YAG).

Laser enfoque: Diodo

Montado en mesa automatizada, gafas de seguridad.

Madrid 05 de octubre de 2018

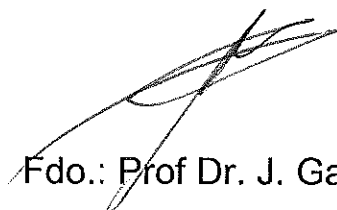

Fdo.: Prof Dr. J. García Feijoo