




LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MUESTRAS
1	1 2	002853 970021	ALARGADERA VENOSA 12-15 CM ALARGADERA VENOSA 30 CM.	<ul style="list-style-type: none">- Tubo alargadera de material plástico, sin punto de inyección.- Con conexión Luer-Lock macho y hembra, con superficies pulidas y bordes redondeados para evitar lesiones en la piel.- Volumen residual máximo 10ml y 24ml respectivamente- Material flexible que permita una buena fijación y que no se acode (sin memoria)- Presión ≥ 2 bar- Exenta de látex y DHEP- En envase individual estéril.- Marcado C.E. Aplicaciones: Para alargar cuando sea preciso la línea de infusión en pediatría.	Nº muestras: 10 c/orden <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Certificado de exención de látex y DHEP: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
2	3	970184	LLAVE 3 PASOS 2 VIAS 	<ul style="list-style-type: none">- Llave de tres vías con cuerpo de policarbonato, totalmente transparente, con dos conectores hembra/macho, conexión luer lock rotatoria que permita una conexión segura con el catéter periférico o central y de fácil conexión con los sistemas de suero en las otras dos salidas.- Certificación de compatible con hemoderivados, lípidos, citostáticos, soluciones alcohólicas y en general con fármacos de alto poder cáustico.- Tapón en cada una de las salidas- De perfil bajo con superficies pulidas y bordes redondeados para evitar lesiones en la piel.- Aletas ergonómicas blancas o transparentes, con flechas indicadoras de la dirección de flujo y giro de 360°- Presión ≥ 3 bar- Mínimo espacio muerto- Exenta de látex- En envase individual estéril.	Nº muestras: 10 uds <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Certificado de exención de látex: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
3	4	970198	REGULADOR FLUJO	<ul style="list-style-type: none">- Tubo flexible de material biocompatible de 40 a 45cm. de longitud, transparente, con dispositivo regulador de flujo de precisión, de pequeño tamaño y mínimo volumen de cebado.- Escala con buena visualización y cortos intervalos, desde 5 ml/hora a 250 ml/hora. Marcas de flujo indelebles.- Mantendrá el ritmo de infusión independientemente del calibre del catéter y de la densidad del líquido.- Conexión luer lock rotatoria al paciente y conexión luer hembra al sistema de infusión.- El dispositivo no deberá presentar riesgo de giro accidental.- Con tope en la regulación. De fácil manejo y fiable en la medición- Envase individual estéril.- Exento de látex y DEHP	Nº muestras: 5 uds <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Certificado de exención de látex y DEHP: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

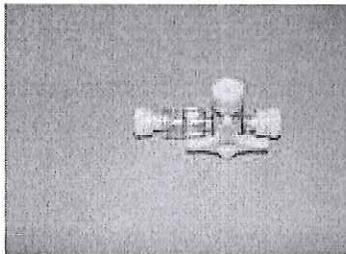

LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MUESTRAS
4	5	005749	TRANSDUCTOR DESECHABLE SIMPLE KIT	<ul style="list-style-type: none">- SIMPLE: Transductor desechable, unido a línea de presión por llave de 3 vías con alargadera de 120cm. unida a alargadera de 25cm ($\pm 5\%$). con llave de 3 vías y en el otro extremo unido a sistema de lavado tipo intraflow, a su vez conectado a sistema de suero sin toma de aire. Dispositivo de lavado rápido consistente- DOBLE: 2 transductores y 3 líneas de presión, más conexión en Y.- Conexión al cable del monitor de fácil manejo- Exentos de látex y DEHP- Marcado C.E.- En envase individual estéril.- El adjudicatario suministrará al Hospital de forma gratuita todos los cables y soportes necesarios para monitorizar. Aplicaciones: Para el registro de las presiones hemodinámicas mediante monitores.	Nº muestras: 4 c/nº orden <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Certificado de exención de látex: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	6	007889	TRANSDUCTOR DESECHABLE DOBLE KIT		

ANEXO:

1. En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas de cada una de la referencia de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
2. Cada uno de los artículos incluidos en este Procedimiento deberá reunir:
☒ **Las condiciones exigidas en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de Octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.**
3. Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica (En castellano o traducida al castellano):
 - Relación de productos ofertados.
 - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna.
 - Muestras: **SI** (Ver columna "MUESTRAS"). En caso de ser necesario un mayor nº de unidades podrían ser solicitadas con posterioridad.**El procedimiento será:**
 - Entregar las muestras en el Almacén del HOSPITAL RAMON Y CAJAL (control de almacenes planta -4 derecha).
 - Cada Licitador deberá entregar en Almacén junto con las muestras dos relaciones en donde aparezca indicado lo siguiente:
 - Nº Procedimiento.
 - Nº de lote-orden.
 - Nombre del proveedor.
 - Al entregar en Almacén las muestras le sellarán las 2 copias, una de ellas se quedará en el Almacén, y la otra copia sellada será entregada al Proveedor.
 - Las muestras deben estar bien identificadas con su número de lote, orden y referencia de la misma, siendo desestimadas las que no cumplan con estos requisitos.
4. Etiquetado en el que figure:
 - La denominación del artículo.
 - El método de esterilización utilizado.
 - Las fechas de caducidad del producto.
 - El número de lote.
 - La referencia comercial.
 - Marcado C.E.
 - Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano
5. Garantía de actualización Tecnológica. En caso de producirse un cambio en la tecnología del material adquirido por este expediente, con renovación de la gama, los modelos adjudicados se actualizarán a los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como mínimo el nivel tecnológico del adjudicado y los precios.





Hospital Universitario
Ramón y Cajal

SaludMadrid



Comunidad de Madrid

SERVICIO DE SUMINISTROS

SUMC

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA CALIDAD

ANEXO 26

LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO	CRITERIOS DE CALIDAD - PUNTOS
1	1	002853	ALARGADERA VENOSA 12-15 CM	1) Fácil manejo sistema conexiones. Calidad del material (rigidez, resistencia , etc). Presentación (sistema envasado, apertura) <ul style="list-style-type: none">▪ Supera calidad media: 30 puntos▪ Calidad dentro de la media: 16puntos.▪ Calidad por debajo de la media: 0 puntos
	2	970021	ALARGADERA VENOSA 30 CM.	
2	3	970184	LLAVE DE 3 PASOS	1) Sistema de anclaje, manejabilidad de las conexiones y giro de aletas. Presentación (sistema envasado, apertura) <ul style="list-style-type: none">▪ Supera calidad media: 30 puntos▪ Calidad dentro de la media: 16puntos.▪ Calidad por debajo de la media: 0 puntos
3	4	970198	REGULADOR DE FLUJO	1) Tamaño dispositivo. Fiabilidad y manejabilidad sistema regulador. Calidad del material (rigidez, resistencia , etc).). Presentación (sistema envasado, apertura). <ul style="list-style-type: none">▪ Supera calidad media: 30 puntos▪ Calidad dentro de la media: 16puntos.▪ Calidad por debajo de la media: 0 puntos
4	5	005749	TRANSDUCTOR DESECHABLE SIMPLE KIT	1) Fiabilidad y manejabilidad (conexiones, alargaderas, etc). Calidad del material (rigidez, resistencia). Presentación (sistema envasado, apertura). <ul style="list-style-type: none">▪ Supera calidad media: 30 puntos▪ Calidad dentro de la media: 16puntos.▪ Calidad por debajo de la media: 0 puntos
	6	007889	TRANSDUCTOR DESECHABLE DOBLE KIT	



P.A. 2015000024

Mat.Sanit.Común: Alargaderas, llaves, regulador flujo, transductor de presión

Página 1 de 1

Fdo.: Mª José VILLARREAL SOLERA
S.A.F. RECURSOS MATERIALES

22/12/2015

 Hospital Universitario Ramón y Cajal  Comunidad de Madrid		ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		ANEXO 25
SaludMadrid SERVICIO DE SUMINISTROS		SUMC		

LOTE	N.O.	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (24 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA incluido)	TIPO DE IVA	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluido)	BASE IMPONIBLE	TOTAL IVA
1	1	002853	ALARGADERA VENOSA FLEXIBLE 12-15 CM	UNIDAD	66.500	0,2844	21	18.909,28	15.627,50	3.281,78
1	2	970021	ALARGADERA VENOSA FLEXIBLE 30 CM	UNIDAD	61.800	0,1970	21	12.174,60	10.061,65	2.112,95
					TOTAL LOTE 1:			31.083,88	25.689,15	5.394,73
2	3	970184	LLAVE 3 PASOS 2 VIAS	UNIDAD	421.900	0,1755	21	74.043,45	61.192,94	12.850,51
3	4	970198	REGULADOR DE FLUJO	UNIDAD	79.200	0,5368	21	42.514,56	35.136,00	7.378,56
4	5	005749	TRANSDUCTOR DESECHABLE SIMPLE KIT	UNIDAD	6.500	5,2685	21	34.245,25	28.301,86	5.943,39
4	6	007889	TRANSDUCTOR DESECHABLE DOBLE KIT	UNIDAD	1.360	12,6658	21	17.225,49	14.235,94	2.989,55
					TOTAL LOTE 4:			51.470,74	42.537,80	8.932,94

IMPORTE TOTAL:	199.112,63	164.555,89	34.556,74
----------------	------------	------------	-----------