

EXPEDIENTE: 2018-0-43

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES RELATIVO A LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE CATÉTERES DE MAPEO Y ABLACIÓN PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con los artículos 116 del TRLCSP, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y 68 del RGLCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del suministro de **CATÉTERES DE MAPEO Y ABLACIÓN PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”**

LOTE	Nº ORDEN	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
1			CARACTERÍSTICAS COMUNES <ul style="list-style-type: none"> • Posibilidad de registro de electrogramas y ablación de miocardio auricular por el mismo sistema. • Capacidad de deflexión bidireccional. • Lumen central para avance de guía de navegación. • Manejo independiente de navegador electroanatómico.
	1	011580	CATÉTER DE ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA Característica específicas: <ul style="list-style-type: none"> • Multielectrodo en disposición circular, válidos para registro y aplicación de radiofrecuencia en el ostium de las venas pulmonares. • Capacidad de aplicación de radiofrecuencia bipolar y unipolar de forma simultánea. • Radiofrecuencia ciclada y por fases. • El sistema debe incluir guía de navegación y cables de conexión a la fuente de radiofrecuencia y al sistema de poligrafía.
	2	011631	SISTEMA PARA CRIOABLACIÓN Compuesto por: Catéter con balón inflable para crioablación del ostium de las venas pulmonares. <ul style="list-style-type: none"> • Catéter circular multipolar para el registro de electrogramas para introducción por el lumen central (tamaño < 3,5 Fr). • Vaina deflectable con diámetro interno de 12 Fr., para la introducción en la aurícula izquierda del sistema de ablación. Debe disponer de marcador radiopaco. Debe incluir dilatador, guía y válvula hemostática. • El sistema debe incluir cable coaxial, cable eléctrico y conector para el catéter diagnóstico.

- El adjudicatario entregará en cesión de uso durante la vigencia del contrato una fuente de radiofrecuencia y una consola de crioablación, y asumirá el mantenimiento y reposición del material necesario para su correcto funcionamiento.


MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: NO

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.


Madrid a, 19 de febrero de 2018.



Fdo. Dra. María López Gil
Jefe De Servicio Cardiología Electrofisiología

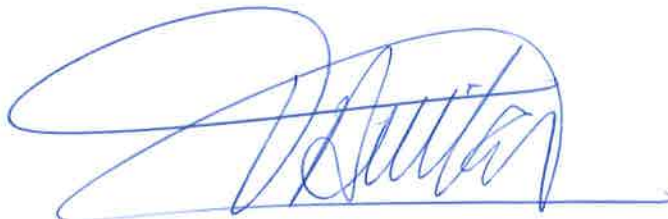

Fdo. Dr. Fernando Arribas Ynsaurriaga
Jefe de Servicio de Cardiología

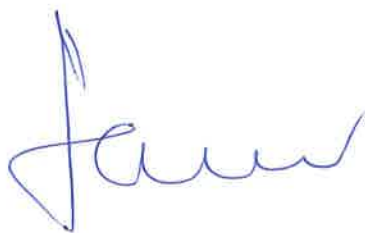

Fdo.: Dr. Francisco Rivas Clemente
Subdirector Médico Área Médica

EXPEDIENTE: 2018-0-43

OBJETO: SUMINISTRO DE CATETERES DE MAPEO Y ABLACION

PRESUPUESTO								
LOTE	ORDEN	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 12 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL
1	1	011580	CATETER DE ABLACION POR RADIOFRECUENCIA	20	2.989,00	59.780,00	12.553,80	72.333,80
	2	011631	SISTEMA PARA CRIOABLACION	15	2.989,00	44.835,00	9.415,35	54.250,35
						104.615,00	21.969,15	126.584,15