

**PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE FIBROSCOPIO Y VIDEO FIBROENDOSCOPIO PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA PEDIATRICA Y ANESTESIA GINECOLOGICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE.**

---

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y el artículo 68 del RGLCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del ***SUMINISTRO DE FIBROSCOPIO Y VIDEO FIBROENDOSCOPIO PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA PEDIATRICA Y ANESTESIA GINECOLOGICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE.***

**LOTE 1: FIBROSCOPIO INTUBACION PEDIATRICO**

- Flexible y ultrafino de luz fría que permita la inserción superior y la aplicación en pediatría.
- Totalmente sumergible en agua o soluciones desinfectantes, no precisando el uso de protectores o adaptadores
- Longitud total 514 mm
- Longitud útil 300 mm
- Diámetro de la punta rígida 2.1 mm
- Diámetro de la parte flexible 2.2 mm
- Angulación hacia arriba 130°
- Angulación hacia abajo 100°
- Angulo de visión recto 75°
- Enfoque de 3 a 50 mm

**Accesorios:**

- Adaptador EOG
- Limpiador de lentes
- Maletín de transporte.

**LOTE 2: VIDEO FIBROENDOSCOPIO FLEXIBLE ADULTO**

**Video endoscopio flexible:**

- Diámetro externo en extremo distal 4-5. 5 mm
- 65 cm de longitud útil
- Acodamiento arriba/abajo 140°
- Provisto de válvula de aspiración
- Intubador para broncoscopios
- Fuente de luz

- Canal de trabajo con  $\varnothing$  interior de 2.5 m
- Adaptador de irrigación
- Verificador de estanqueidad (test de fugas)
- Tapón compensador de presión
- Tapa de cierre
- Tapa de protección
- Protección contra salpicaduras y golpes
- Cepillo y material necesario para la limpieza
- Permitir la desinfección y limpieza por frotado

**Monitor para endoscopios:**

- Pantalla de 7" al menos
- Entrada para cámara
- Conexión USB Y HDMI
- Capacidad de manejo de imágenes en tiempo real, grabación y reproducción de secuencias.
- Posibilidad de transferencias de imágenes a memoria externa
- Adaptador para conexión a red

**Accesorios:**

- Fuente de alimentación del videofibroscopio y del monitor
- Baterías
- Cargador

**MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: NO**

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.


Madrid, 12 de septiembre de 2018

**Subdirector Médico Materno-Infantil**

  
Hospital Universitario  
12 de Octubre  
SaludMadrid  
Subdirección Médica Materno-Infantil

Fdo: Dr. Santiago Artillo Rembrado

**Por el Servicio de Cirugía Pediátrica**

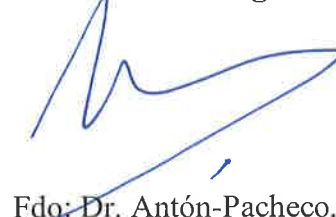  
Fdo: Dr. Antón-Pacheco.

**Por el Servicio Anestesia Obstétrica-Ginecológica**

  
Fdo.: Dra. Tebar Cuesta

## ANEXO AL PPT

### Requisitos de instalación y mantenimiento

#### 1.-Instalacion


- Los equipos se suministrarán con todos aquellos dispositivos o elementos de interconexión, accesorios de anclaje o fijación necesarios para un total y correcto funcionamiento y obtención de los correspondientes permisos o autorizaciones requeridas por la legislación vigente.
- Los equipos serán montados por el adjudicatario en el local de destino en condiciones de funcionamiento, incluyendo la retirada de elementos de embalaje así como del equipo al que sustituya independientemente de su ubicación en el Centro o en cualquiera de los CEPS adscritos), en caso de que sea necesario.

#### 2.-Informacion del equipo

- El adjudicatario deberá entregar la siguiente documentación en español:
  - Manual de instrucciones y operaciones, en formato electrónico.
  - Manual de mantenimiento, en formato electrónico.
- El adjudicatario deberá actualizar los manuales en español cuando se incorpore alguna modificación a las características del equipo.
- Los equipos se suministrarán con la última versión de software disponible. Se actualizarán los programas ofertados, sin coste adicional, durante el periodo de garantía (incluida ampliación de garantía si ha sido ofertada por el adjudicatario).
- El adjudicatario colaborará con la Unidad de Electromedicina del Hospital en la inclusión de toda la información necesaria de los equipos en el inventario técnico disponible en la Unidad.

#### 3.-Garantía y mantenimiento

- La garantía del equipo incluye durante su vigencia el servicio de mantenimiento en la modalidad “todo incluido con garantía total” y mantenimiento técnico-legal sin coste adicional para el Hospital
- El adjudicatario está obligado a disponer de todos los repuestos, accesorios, componentes, kits, consumibles que puedan ser necesarios para el correcto mantenimiento preventivo, correctivo y técnico-legal durante un periodo mínimo de 10 años

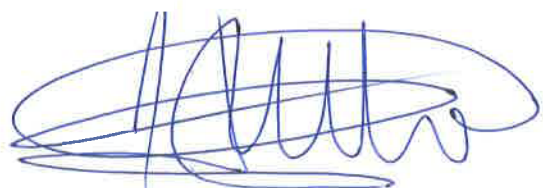

## ANEXO II

EXPEDIENTE 2018-0-170

**OBJETO: SUMINISTRO DE FIBROSCOPIO Y VIDEO FIBROENDOSCOPIO SERVICIOS DE C. PEDIATRICA Y ANESTESIA GINECOLOGIA DEL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE**

				PRESUPUESTO			
LOTE	COD. ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA 21%	IMPORTE TOTAL
1	221969	FIBROSCOPIO INTUBACION PEDIATRICO	1	8.850,00	8.850,00	1.858,50	10.708,50
2	222233	VIDEO FIBROENDOSCOPIO FLEXIBLE ADULTOS	1	10.454,00	10.454,00	2.195,34	12.649,34
					<b>19.304,00</b>	<b>4.053,84</b>	<b>23.357,84</b>

