

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACLARACIONES POR LA EMPRESA GE AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS POR EL QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA DEL CONTRATO DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN VEINTICINCO ELECTROCARDIOGRAFOS CON INTEGRACIÓN A LA HISTORIA CLÍNICA PARA EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO "GREGORIO MARAÑÓN"

EXPTE: A/SUM-017656/2018

25 ELECTROCARDIÓGRAFO:

- a) En los requisitos mínimos se indica: "Se proporcionará, instalará y configurará al menos 3 TB netos de almacenamiento de acceso rápido dedicados dentro de la infraestructura existente del Hospital para que estén accesibles desde la aplicación".

Se aclara que el hospital ha adquirido una solución multi-site, activo-activo, para entornos virtualizados con alta disponibilidad y replicación on-line de los datos. La cabina de almacenamiento es una OceanStor 2600 V3-3.5 HUAWEI. Se precisan 6 discos de 600 GB SAS de 15K por cada site, en total 12 discos


- b) En los requisitos mínimos se indica: "Adquisición de 25 electrocardiogramas de 12 canales y tira de ritmo, altas prestaciones con registro térmico continuo DIN A velocidad de impresión 5, 12.5, 25 y 50 mm/s".

Se aclara que el tamaño DIN A es tamaño DIN A4.

Madrid, 08 de octubre de 2018

EL JEFE DEL Sº
DE CARDIOLOGÍA

Francisco Fernández-Avilés Díaz

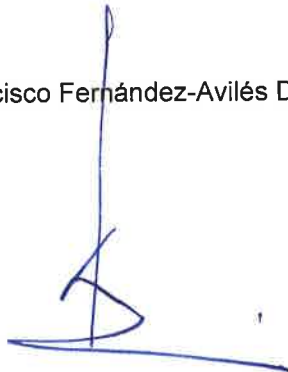

EL TÉCNICO RESPONSABLE
DE ELECTROMEDICINA

Eugenio Herrero Alonso

