

EXPEDIENTE: 2020-0-73

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA CIRUGIA ARTROSCOPICA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato tiene por objeto el suministro de material fungible para cirugía artroscópica y equipamiento sin cargo, en cesión de uso, durante la vigencia del contrato, para la realización de la técnica en el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital.

LOTE 1

LOTE	Nº ORDEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
1	1	<p><u>CARTUCHOS IRRIGACION BOMBA DE ARTROSCOPIA.</u></p> <p>Sistema de cartuchos desechables de un solo uso, de plástico sin látex y libres de PVC para Bomba de artroscopia con control de irrigación y succión para cánula, motor de artroscopia y vaporizador</p>
	2	<p><u>TERMINALES MOTOR DE ARTROSCOPIA.</u></p> <p>TERMINALES PARA TEJIDO BLANDO (sinovio y meniscotomos)</p> <p>Disponibles en distintos diámetros (2,5; 3,5; 4; 5 y 5,5mm) y distintas longitudes para utilizar en todas las articulaciones.</p> <p>TERMINALES CORTADOS POR LASER</p> <p>Disponibles en diferentes medidas. Diseñados para reducir partículas metálicas.</p> <p>TERMINALES PARA HUESO (fresas)</p> <p>Disponibles en distintos diámetros (2; 3; 3,5; 4; 5 y 5,5mm) y distintas longitudes para utilizar en todas las articulaciones; diferentes terminaciones tanto de la fresa como de la cubierta protectora.</p> <p>Fresas artroscópicas de diamante en medidas de 4 y 5,5mm</p>
	3	<p><u>SISTEMA DE RADIOFRECUENCIA (VAPORIZADOR).</u></p> <p>Posibilidad de distintos terminales con diferentes terminaciones y varios diámetros (2,5; 3,5 y 4mm) con la pieza de mano integrada en el electrodo y la posibilidad tanto de mando manual como de pedal para activar el corte, la coagulación y modificar los niveles de potencia.</p> <p>Posibilidad de aspiración incorporada en el cabezal.</p>

OTROS REQUISITOS:

El adjudicatario dejará en Cesión de uso, durante la vigencia del contrato, 4 Torres de Artroscopia:

- Asimismo el adjudicatario entregará doble juego del material esterilizable (por cada una de las torres) necesario para el uso de las torres.
- En caso de avería del equipamiento se realizará un préstamo del mismo en un periodo máximo de 48 horas y hasta la reparación del equipo.
- Todos los gastos de instalación de la torre serán por cuenta del adjudicatario.

TORRES DE ARTROSCOPIA CON LA SIGUIENTE COMPOSICION Y CARACTERISTICAS:

CAMARA ARTROSCOPIA

Cámara CMOS
Resolución Full HD 1080 p
Pantalla LCD táctil.
Cabezal de Cámara con botones de control programables.
Salidas digitales (DVI), analógicas (S-Vídeo) y fibra óptica.
Cabezal con adaptador focal de 18 mm.
Esterilizable.
Exenta de látex.

FUENTE DE LUZ LED.

Pantalla LCD táctil.
Activación desde el Cabezal de Cámara.

MONITORES

Tecnología LED
Monitor 26"
Resolución 1920 x 1080p
Salidas HD y HDTV.
Conexiones digitales y analógicas: DVI, VGA, SD-SDI, S-VIDEO, FIBRA OPTICA.

CONSOLA MOTOR ARTROSCOPIA – VAPORIZADOR.

Sistema de resección artroscópica que combina sistema de ablación por radio frecuencia (vaporizador) y motor de artroscopia (sinoviotomos y fresas).

BOMBA ARTROSCOPIA

Bomba de artroscopia con control total de **irrigación y succión**, integrada con motor y vaporizador.
Rango de flujo: 0 – 3 l/m
Valores predeterminados y modificables por articulación tanto para flujo de entrada como para presión.
Función de lavado rápido.
Posibilidad de control remoto

CARRO ARTROSCOPIA PORTA CONSOLAS.

Carro para alojar y transportar los componentes de la torre.

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: NO


- o No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

OTROS

El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato.

Madrid, a 19 de diciembre de 2019

SERVICIO DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA

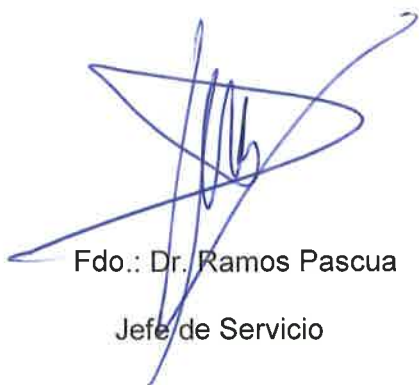

Fdo.: Dr. Ramos Pascua
Jefe de Servicio



Fdo.: Dr. García-Rayo
Jefe de Sección

EXPEDIENTE : 2020-0-73

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA CIRUGIA ARTROSCOPICA PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA

						PRESUPUESTO				VALOR ESTIMADO (incluida modificación) 20%	EPIGRAFE
LOTE	Nº ORDEN	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 24 MESES	PRORROGA 24 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA 21%	IMPORTE TOTAL		
1	1	170001	CARTUCHOS IRRIGACION BOMBA DE ARTROSCOPIA	500	500	32,900	16.450,00	3.454,500	19.904,50	36.190,00	27004
	2	170002	TERMINALES MOTOR DE ARTROSCOPIA	1.400	1.400	72,000	100.800,00	21.168,000	121.968,00	221.760,00	27004
	3	170003	SISTEMA DE RADIOFRECUENCIA (VAPORIZADOR)	800	800	134,00	107.200,00	22.512,000	129.712,00	235.840,00	27004
							224.450,00	47.134,50	271.584,50	493.790,00	