

**PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE CIRCUITO DESECHABLE PARA OXIGENOTERAPIA ALTO FLUJO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE**

**OBJETO DEL CONTRATO**

El presente contrato tiene por objeto el Suministro de Circuito desechable para oxigenoterapia alto flujo, con cesión de uso y sin coste alguno para el Hospital durante la vigencia del mismo, de los equipos necesarios para la realización de la técnica y cuyas características se detallan en este Pliego.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

LOTE	Nº ORDEN	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCIÓN TECNICA)
1	1	018906	<b>SISTEMA DE OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUJO</b> <i>compuesto de:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Circuito desechable para oxigenoterapia de alto flujo, con o sin turbina.</li> <li>Cánula nasal y de traqueotomía para oxigenoterapia de alto flujo, compatible con el circuito desechable. Deberá disponer al menos de 2 tamaños.</li> <li><b>Indicación:</b> Para utilización en unidades especiales (UCI, Reanimación).</li> </ul>
	2	018907	

**CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO**

Para la utilización del fungible, la empresa adjudicataria cederá durante la vigencia del concurso 8 equipos (5 para UCI y 3 para Reanimación), con las siguientes características:

- Funcionamiento por turbina o con conexión a toma mural de aire comprimido medicinal.
- Flujo máximo igual o superior a 70 lpm.
- Temperatura regulable entre 31 y 37°C
- Sistemas de interfase mediante gafas nasales (con al menos dos tallas disponibles) y conexión a traqueotomía.
- Sensor de oxígeno integrado en equipo con medición de FiO2 en tiempo real.
- Rango de FiO2 regulable entre 0.21 y 1 con cualquier valor de flujo.
- Sistema integrado en un carro que permita su movilidad y posibilidad de colocarlo en modo sobremesa.
- Batería interna para posibilitar traslados del paciente.

### MUESTRAS

Para la evaluación de los productos se solicitan muestras **NO**


Lugar de Entrega: **Almacén General. Edificio MI planta -2**

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

### OTROS

El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato.

Madrid, 17 de junio de 2020

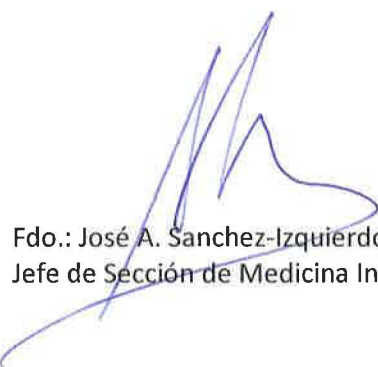

Fdo.: José A. Sanchez-Izquierdo Riera  
Jefe de Sección de Medicina Intensiva



Fdo.: Dr. Manuel Cortés Guerrero  
Jefe de Servicio de Anestesia y REA R.G.

EXPEDIENTE: 2020-0-147

OBJETO: SUMINISTRO DE CIRCUITO DESECHABLE OXIGENOTERAPIA ALTO FLUJO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

						PRESUPUESTO				VALOR ESTIMADO (incluida modificación)	EPIGRAFE
LOTE	ORDEN	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD INICIAL 12 MESES	CANTIDAD PRORROGA 12 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA 21%	IMPORTE TOTAL		
1	1	018906	Circuito desechable para oxigenoterapia alto flujo con o sin turbina	350	350	59,300	20.755,00	4.358,55	25.113,55	45.661,00	27004
	2	018907	Cánula nasal y de traqueotomía para oxigenoterapia de alto flujo para equipo con o sin turbina	380	380	23,000	8.740,00	1.835,40	10.575,40	19.228,00	27004
							<b>29.495,00</b>	<b>6.193,95</b>	<b>35.688,95</b>	<b>64.889,00</b>	