

EXPEDIENTE: 2021-0-70

**PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE PARA
TRANSDUCTORES DE PRESION SANGUINEA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE**

OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato tiene por objeto el suministro de transductores de presión sanguínea para el Hospital.

El Expediente consta de los siguientes lotes:

LOTE	Nº ORDEN	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
1	1	014923	<p>SISTEMA DE PRESIÓN SANGUÍNEA, CON UN TRANSDUCTOR COMPUESTO POR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rango de trabajo: de - 50 a 300 mm Hg. • Rango de temperatura de funcionamiento: De 15 a 40 grados centígrados. • Sensibilidad: 5 micro V/V/mm Hg. $\pm 1\%$ • Cuerpo transparente. • Conexiones luer-look. <p>Además deberá contener los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un sistema de lavado por flujo continuo, de 3 ml/hora presurizado a 300 mm Hg posibilidad de lavado rápido. • Dos llaves de tres vías. • Una alargadera de 150 cm. • Una alargadera de 30 cm. • Todas las salidas vendrán con tapones incorporados y todas las conexiones deberán ser de tipo luer look. • Según esquema del Anexo a este Pliego.
	2	014924	<p>SISTEMA DE PRESIÓN SANGUÍNEA, CON DOS TRANSDUCTORES COMPUESTO POR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rango de trabajo: de - 50 a 300 mm Hg. • Rango de temperatura de funcionamiento: De 15 a 40 grados centígrados. • Sensibilidad: 5 micro V/V/mm Hg. $\pm 1\%$ • Cuerpo transparente. • Conexiones luer-look.

LOTE	Nº ORDEN	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
			<p>Además deberá contener los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dos sistemas de lavado por flujo continuo de 3 ml/hora presurizado a 300mm Hg con posibilidad de lavado rápido. • Cuatro llaves de tres vías. • Dos alargaderas de 150 cm. • Dos alargaderas de 30 cm. • Todas las salidas vendrán con tapones incorporados y todas las conexiones deberán ser de tipo luer lock • Según esquema del Anexo a este Pliego

MUESTRAS

Para la evaluación de los productos se solicitan muestras **SI**

Cantidad de muestras: **2 por LOTE**

Lugar de Entrega: **Almacén General. Edificio MI planta -2**

- No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar **más** muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto


FORMACION

La empresa adjudicataria deberá formar, sin coste alguno para el Centro, si es preciso, al personal que se determine para el correcto uso de los productos, entregándose sin cargo el material docente necesario para la formación.

OTROS

El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato.


Madrid, a 25 de febrero de 2021




Fdo.: Juan Carlos Montejo González
JEFE DE SERVICIO DE MED. INTENSIVA

ANEXO PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS Expediente 2021-0-70

Nº de orden 1: Código 014923

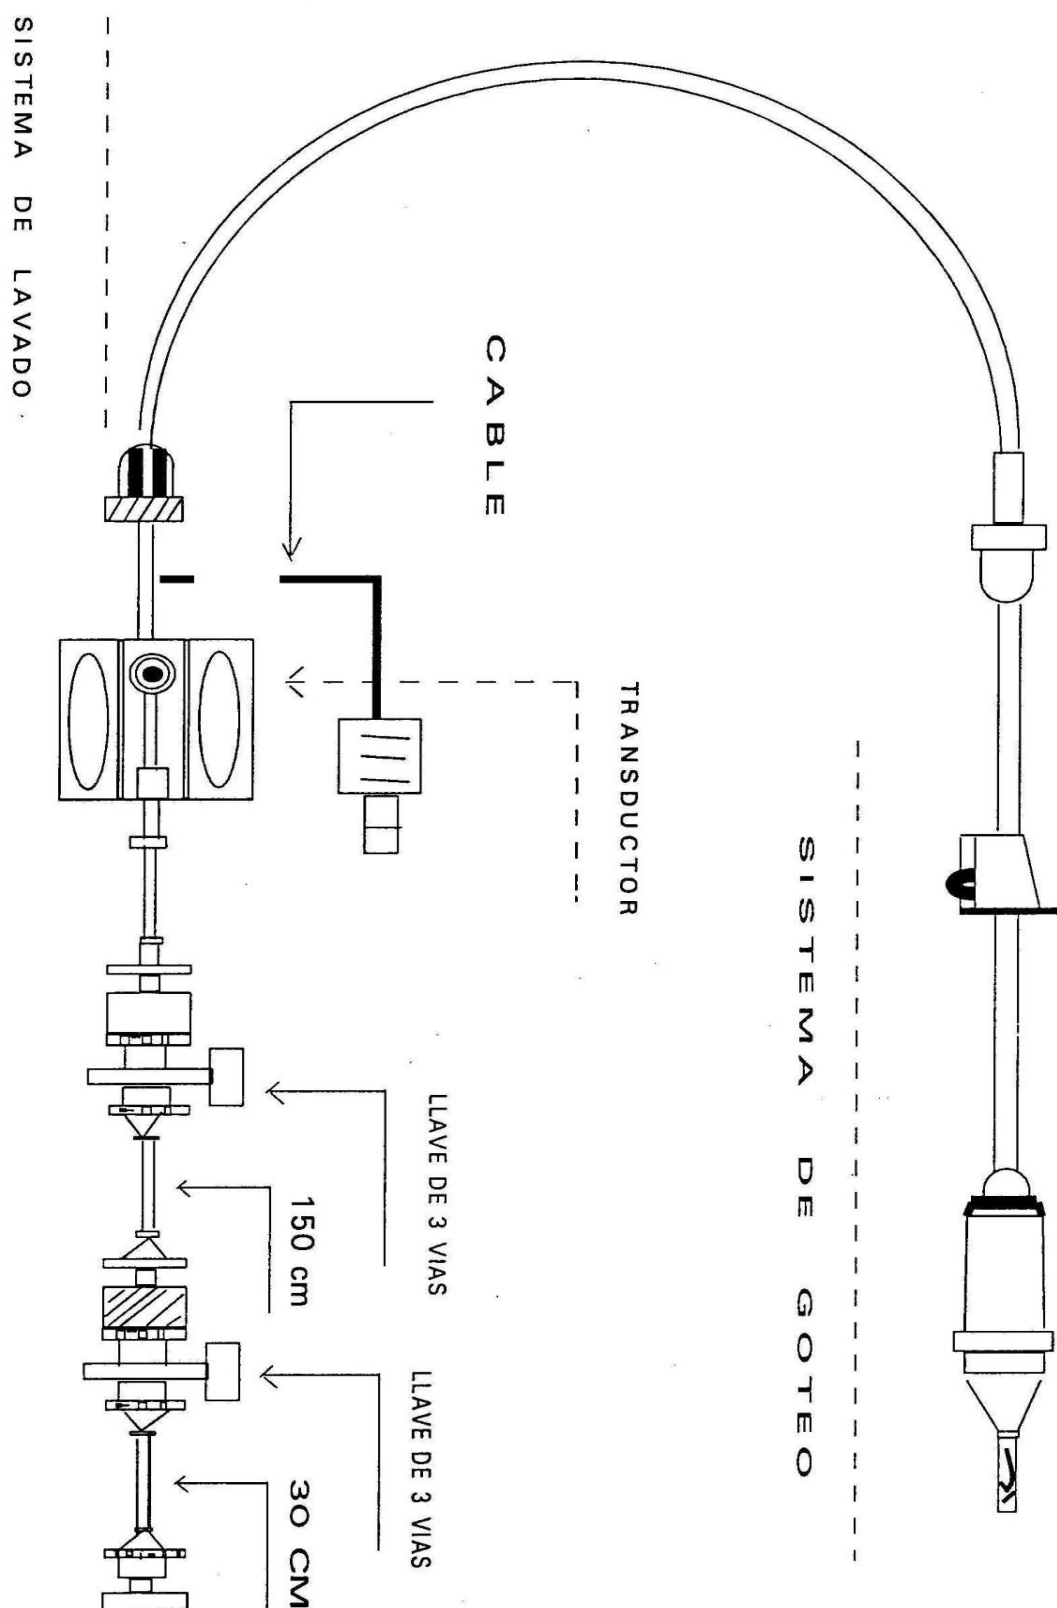

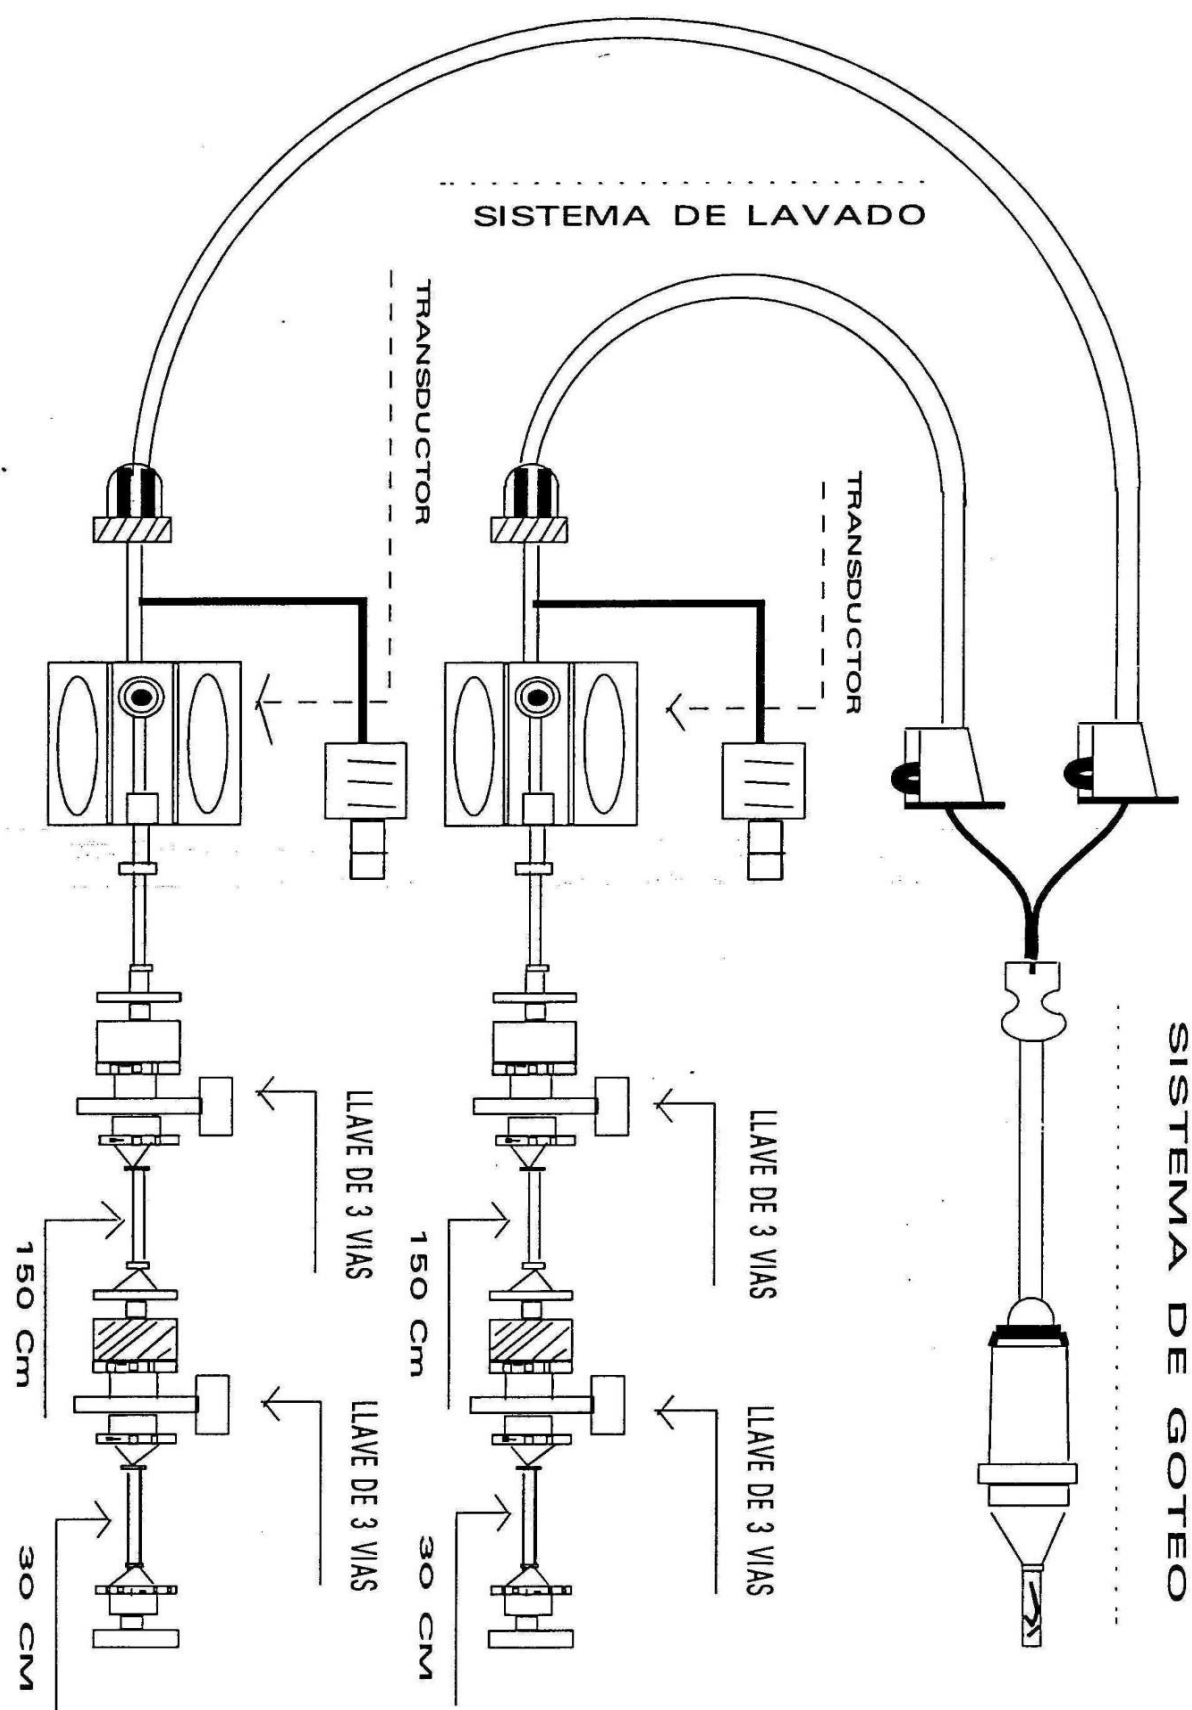

EXPEDIENTE: 2021-0-70

OBJETO: SUMINISTRO DE TRANSDUCTORES DE PRESION SANGUINEA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

						PRESUPUESTO					
LOTE	Nº ORDEN	CODIGO	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD INICIAL 24 MESES	CANTIDAD PRORROGA 24 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO (incluida 20% modificación)	EPIGRAFE
1	1	014923	SISTEMA DE PRESION SANGUINEA 1 TRANSDUCTOR	10.840	10.840	5,50	59.620,00	12.520,2000	72.140,2000	131.164,000	27004
	2	014924	SISTEMA DE PRESION SANGUINEA 2 TRANSDUCTORES	5.180	5.180	10,19	52.784,20	11.084,6820	63.868,8820	116.125,240	27004
							112.404,20	23.604,8820	136.009,0820	247.289,240	