


INFORME TÉCNICO – SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA REALIZACIÓN DE TÉCNICAS DE RADIOFRECUENCIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO EL ESCORIAL

- **PRIMERO:** revisada la documentación técnica del equipo de radiofrecuencia aportado por la empresa adjudicataria PRIM, S.A. constatamos lo siguiente:

En lo referente al equipo en cesión "Generador de RF", los parámetros de temperatura, impedancia y voltaje se muestran de forma numérica y no en forma de gráfica en relación con el tiempo. Si bien este hecho no representa un problema de seguridad ni una merma en las prestaciones del equipo, es cierto que **no cumple** con el requisito del pliego técnico que especifica como característica "*Pantalla con gráficas informativas: temperatura-tiempo, impedancia-tiempo y voltaje-tiempo*" (cláusula 6ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).

- **SEGUNDO:** Una vez analizada la documentación técnica aportada por la casa comercial CARDIVA 2, S.L, para el suministro de material fungible para la realización de técnicas de radiofrecuencia en la Unidad de Dolor Crónico del Hospital de El Escorial, se objetiva que la misma **sí cumple** con los requisitos técnicos requeridos.

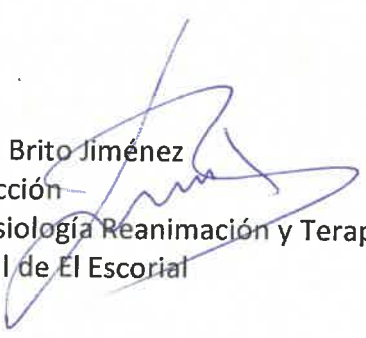

Dr. Luis Brito Jiménez
Jefe Sección
Anestesiología Reanimación y Terapéutica del Dolor
Hospital de El Escorial

San Lorenzo de El Escorial
25/01/2023