


PASA 232-2025 "ADQUISICIÓN DE SILLONES GINECOLÓGICOS ELÉCTRICOS CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE ÚNICO: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

UNICO									
LOTE	LICITADOR	DESCRIPCIÓN	MODELO O REFERENCIA	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS			CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 30 PUNTOS)		TOTAL (MÁXIMO 30 PUNTOS)
				SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	PEDAL DE CONTROL SI = 30 PUNTOS		
							SI / NO	PUNTOS	
	COMPLEMENTOS HOSTELEROS SANITARIOS, S.L.	SILLONES GINECOLÓGICOS	SE-2330-BRG		X	* Se solicita rango de altura entre 55 y 95 cms como mínimo y se oferta entre 56 y 84 cms * Se solicita Trendelenburg de 21º y oferta 10º			
	OFICACERES, S.L.	SILLONES GINECOLÓGICOS	14655		X	* Se solicita rango de altura entre 55 y 95 cms como mínimo y se oferta entre 52 y 92 cms * Se solicita Trendelenburg de 21º y oferta 10º * No especifica rotación de las perneras * No especifica superficie resistente a la abrasión * No especifica superficie desinfectable con amonios cuaternarios			
	OPTOMIC ESPAÑA, S.A.	SILLONES GINECOLÓGICOS	68303100	X			SI	30,00	30,00
	SCHMITZ MEDICAL IBERICA, S.L.	SILLONES GINECOLÓGICOS	114.9600.0	X			SI	30,00	30,00

Leganés, a 26 de noviembre de 2025

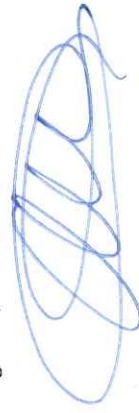

Anna Cruz Postbauer Correas
SUPERVISORA RECURSOS MATERIALES